

胃瘻交換用カテーテル (ゼロフラット)




短期
留置

バルーン
チューブ

医療機器認証番号：21600BZZ00449000

バルーンとチューブの段差が無く、
先端が突出しない
ゼロフラットタイプ

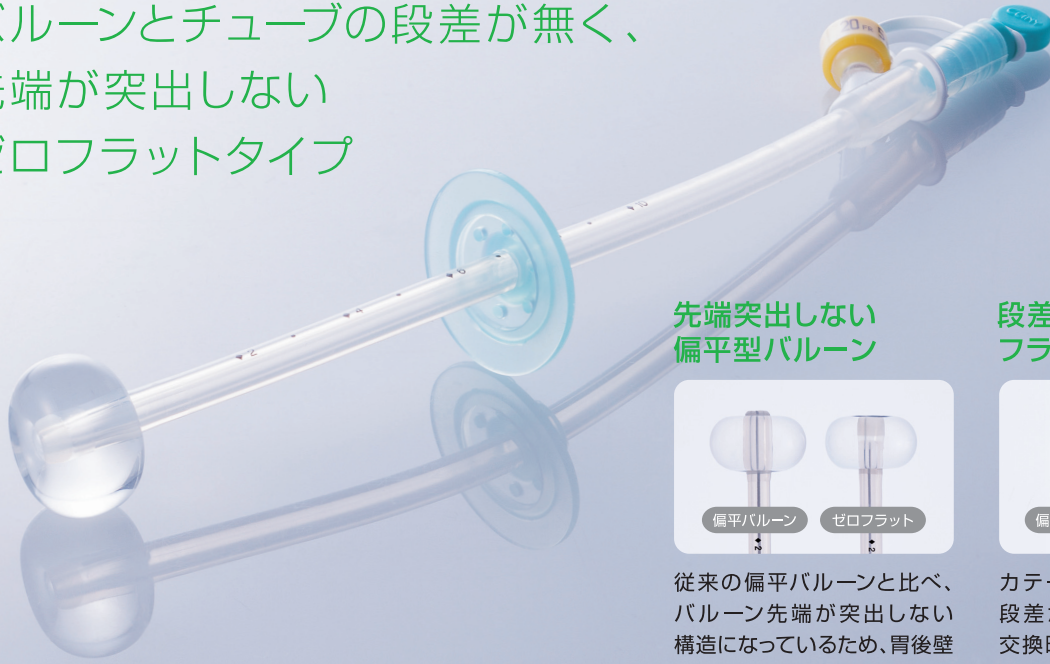

先端突出しない
扁平型バルーン



従来の扁平バルーンと比べ、
バルーン先端が突出しない
構造になっているため、胃後壁
へのカテーテル接触の危険性を
軽減させます。

段差の少ない
フラットチューブ



カテーテルとバルーン部の
段差がほとんどない構造は
交換時の挿入性を高め、抜去
時には抵抗を低減させます。
(*12Frを除く)

仕様

品目コード	サイズ呼称	規定容量	カテーテル全長	JANコード
800 000 9265	12Fr	3mL	225mm	4542187149074
800 000 9266	14Fr			4542187149081
800 000 9267	16Fr			4542187149098
800 000 9268	18Fr	4542187149104		
800 000 9269	20Fr	5mL		4542187149111
800 000 9270	22Fr			4542187149128
800 000 9271	24Fr			4542187149135

● カテーテル仕様 …… X線造影ライン・バルーン後端から20~100mmまで10mm間隔のデブスマーク・先端開孔・交換用ロッド

2本/箱・EOG滅菌済

□ 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
□ ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。

クリエートメディック株式会社

本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25
ホームページ <http://www.createmedic.co.jp>